

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-075/2014  
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO  
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO LA LIC. **MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO, LA CONVOCANTE BASÁNDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MAS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

**CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	S/C	<p><b>RIEL PORTAVENOCLISIS. CATÁLOGO PÁGINA ÚNICA</b></p> <p>1.-BARRA REDONDA DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO CON SISTEMA DE MUESCAS PARA FIJACION A TRES DIFERENTES ALTURAS, ACABADO CROMADO. 2.-BARRA REDONDA DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3.-HERRAJES Y CARRETILLAS PARA DESLIZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO, DE PLASTICO COLOR GRIS. 4.-MECANISMO DE FIJACION A DIFERENTES ALTURAS CON SISTEMA DE BOTON TIPO TRINQUETE DE PLASTICO COLOR GRIS. 5.-SOPORTE DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO. 6.-TOPE DE SEGURIDAD PARA LA CARRETILLA DE PLASTICO.</p> <p>DIMENSIONES 1.20 DE LONGITUD ALTURA CON BARRA 65 CM.</p> <p>MARCA: PROMEDIMEX MODELO: S/M PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PIEZA	16	\$1,500.00	\$24,000.00
<b>IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:</b>					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$24,000.00</b>
<b>(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. )</b>					<b>I.V.A.</b>	<b>\$3,840.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$27,840.00</b>

DESENLACE ADMINISTRATIVO, S.C.

LICITANTE: DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		ASPIRADOR PORTÁTIL DE ENFERMERÍA, INCLUYE FRASCO RECOLECTOR, SISTEMA TUBULAR CONECTADO AL CATÉTER DE ASPIRACIÓN Y UN MECANISMO QUE REGISTRE EL GRADO DE SUCCIÓN. TIPOS DE SUCCIÓN OROFARINGEA Y NASOFARINGEA. ORIGEN RUMANIA MARCA HERGOM MODELO UNICO	PIEZA	2	\$12,840.00	\$25,680.00
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:					<b>SUBTOTAL</b>	\$25,680.00
(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHETA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)					<b>IVA</b>	\$4,108.80
					<b>TOTAL</b>	\$29,788.80

INFUSOMED, S.A. DE C.V.

LICITANTE: INFUSOMED, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION CONFORME A PROPUESTA TECNICA INDICANDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	513.621.1603	MESA PASTEUR CROMADA BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. Dimensiones generales: Ancho 64cm x Fondo 47cm x Altura 100cm. MARCA: ESGO MODELO: MES603 PROCEDENCIA: MEXICO	PZA	10	1,760.00	17,600.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA					<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 17,600.00
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)					<b>IVA</b>	\$ 2,816.00
					<b>TOTAL</b>	\$ 20,416.00

## PROVEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
PAR-TIDA	CLAVE	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA INCLUYENDO MARCA, MODLEO Y PROCEDENCIA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2		<p><b>BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS</b>            CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA ACABADO BARNIZ MARINO NATURAL TRES CAPAS, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL 18 DE 32 X 32 MM ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, REGATON DE ALUMINIO O DE PLASTICO DE 1" DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE DIMENSIONES : 1.20 DE LARGO X 0.30M DE ANCHO X 0.45 M DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +- 1 CM.  <b>MARCA: HERLIS</b>  <b>MODELO: SIN MODELO</b>  <b>PROCEDENCIA: MEXICO</b></p>	PIEZA	1	\$1,361.00	\$1,361.00
5		<p>1. <b>CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS EQUIPO QUE CONTINUAMENTE RECIBE Y DESPLIEGA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES DE UNO O MÁS MONITORES DE PACIENTE O SISTEMAS DE MONITOREO.</b>            Según la junta de aclaraciones las características mínimas del procesador deberán ser de 3.2 GHZ dual Xenon processor, 1 Gb de ram, espacio en disco duro de por lo menos 140 gb, Sistema operativo Linux, tarjeta de video dual, 2 puertos Ethernet, 2 puertos Rs232 Asíncronos, 4 puertos USB, tarjeta de sonido, Speakers. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22, 310. Anexo 1.            2. <b>CUENTA CON SEÑALES DE ALARMAS VISIBLES Y/O AUDIBLES CUANDO CONDICIONES ADVERSAS SON REGISTRADAS.</b> Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 158.            3. <b>GENERALMENTE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS O EN SALAS DE CUIDADOS CORONARIOS, DONDE EL PERSONAL PUEDE MONITORIZAR VARIOS PACIENTES DE MANERA SIMULTÁNEA.</b> Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.            4. <b>CANTIDAD DE PACIENTES PARA MONITORIZAR A ELEGIR POR EL USUARIO.</b> Según la junta de aclaraciones el equipo deberá contar con 16 monitores de signos vitales. Folleto Monitores de Paciente Infinity Delta y Delta XL pág. 1.</p>	PIEZA	1	\$3,910,500.00	\$3,910,500.00
		<p>5. <b>CON CAPACIDAD PARA CONECTAR 16 MONITORES DE SIGNOS VITALES COMO MÍNIMO.</b> Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.            6. <b>PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 17"</b></p>				

COMO MÍNIMO. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 310.

7. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS DE CADA PACIENTE Ó 31 CURVAS EN TOTAL COMO MÍNIMO. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 64.

8. CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE SELECCIONADO. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 108.

9. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES EN LA CENTRAL DE TODOS LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES. ALMACENAMIENTO DE EVENTOS O ALARMAS. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 159, 170.

10. HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 169.

11. CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 24 HORAS. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.

12. IMPRESORA LÁSER. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.

13. INTERFACE DEL USUARIO EN ESPAÑOL. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 27.

14. CON TECLADO Y MOUSE. Según la junta de aclaraciones estos periféricos deber ser a prueba de agua para que permitan ser lavados y desinfectados. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22. Anexo 2.

15. UNIDAD DE RESPALDO UPS. Anexo 3.

16. CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y ALARMAS ENTRE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA CENTRAL. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 108.

17. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.

18. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. Instrucciones de uso de Infinity CentralStation pág. 22.

19. LA CANTIDAD DE MONITORES DEBERÁN SER ELEGIDOS DE ACUERDO POR EL USUARIO CON LAS SIGUIENTES

	<p>CARACTERÍSTICAS: Ver puntos subsecuentes.                  20. - MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MÍNIMO. Se oferta monitor de 10.4 pulgadas. Folleto Monitores de paciente Infinity Delta y Delta XL pág. 1, 4, 5.                  21. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA. Folleto Monitores de paciente Infinity Delta y Delta XL pág. 5, 1.                  22. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES DEBE DE INCLUIR ACCEOSORIOS NEONATALES PARA ECG, TEMP, SPO2, NIBP. Folleto Accesorios monitoreo.  <b>MARCA: DRAGER</b>  <b>MODELO: ISC+DELTA</b>  <b>PROCEDENCIA: E.U.A.</b></p>				
<p>6</p>	<p><b>INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL RECIÉN NACIDO.</b>                  1. EQUIPO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AMBIENTE CERRADO Y CONTROLADO, PARA MANTENER LOS NIVELES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD APROPIADOS PRINCIPALMENTE EN LOS RECIÉN NACIDOS QUIENES NO PUEDEN REGULAR EFECTIVAMENTE SU TEMPERATURA CORPORAL, INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 24. FOLLETO C2000, PÁG. 3, 4.                  2. TÍPICAMENTE INCLUYE MEDIOS PARA CALENTAR AL BEBE PROPORCIONANDO AIRE CALIENTE A TRAVÉS DE CONTROLES DE TEMPERATURA QUE TRABAJAN DE MANERA AUTOMÁTICA MIDIENDO LA TEMPERATURA DEL AIRE A TRAVÉS DE UN SENSOR DE TEMPERATURA COLOCADO EN LA PIEL DEL PACIENTE Y CONTROLES DE HUMEDAD, INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 25, 26, 24.                  3. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICRO CONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 24, 98.                  4. CONTROL CON MODO SERVO CONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE AIRE DE 20°C, A MÁXIMO 37°C, CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C HASTA 39°C. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 26.                  5. CONTROL CON MODO SERVO CONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO</p>	<p>PIEZA</p>	<p>4</p>	<p>\$216,238.28</p>	<p>\$864,953.12</p>

Declaración

DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 38°C. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 26.

6. RESOLUCIÓN DE 0.1°C. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 63, 64.

7. SISTEMA DE SERVO CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1%. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 24, 120.

8. SISTEMA DE HUMIDIFICACION CON SERVO CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA DE 30% A 95% CON INCREMENTOS NO MAYORES A 1%. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 24.

9. DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35.

9.1 TEMPERATURA DE AIRE MEDIDA Y PROGRAMADA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35.

9.2 TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE MEDIDA Y PROGRAMADA, CON MONITOREO SIMULTANEO DEL DOS TEMPERATURAS DE PIEL DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35, 66.

9.3 HUMEDAD RELATIVA MEDIDA Y PROGRAMADA, INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35.

9.4 CONCENTRACIÓN DE OXIGENO MEDIDA Y PROGRAMADA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35.

10. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 37.

11. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 35.

12. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES EL CAPACETE DEBE AISLAR EL RUIDO PERMITIENDO SOLO UN NIVEL DE 47 DB EN SU INTERIOR. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 119.

13. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES LA INCUBADORA DEBE CONTAR CON BÁSCULA INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL COLCHÓN CON DESPLIEGUE DEL PESO EN PANTALLA DE LA INCUBADORA Y TENDENCIAS DEL PESO DE HASTA 7 DÍAS. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA C2000, PÁG. 120, 25, 73, 84.

MARCA: DRAGER

MODELO: C2000

Handwritten signature or initials.

7	<p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p> <p><b>INCUBADORA DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO.</b></p> <p>1. EQUIPO DE TRASLADO CON CUBIERTA TRANSPARENTE, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AMBIENTE CERRADO CONTROLANDO LA TEMPERATURA DEL AIRE INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 1-5, 2-1.</p> <p>2. INCUBADORA DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 1-5.</p> <p>3. CON MODOS DE OPERACIÓN: CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE DIRECTA Y BATERÍA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-2</p> <p>4. MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-3.</p> <p>5. CONTROLES: CON CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 21.5°C A 38° C. CON RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES SE PERMITE OFERTAR RANGO DE 21.5° A 38°C. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-5.</p> <p>6. CON SISTEMA DE BLOQUEO EN EL PANEL DE CONTROL PARA EVITAR MODIFICACIONES ACCIDENTALES DE LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS. ACTIVADO CON TECLA, BOTÓN O SECUENCIA DE TECLAS. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-3.</p> <p>7. MONITOREO DE PARÁMETROS: DESPLIEGUE DIGITAL E INDEPENDIENTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-3.</p> <p>7.1 TEMPERATURA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-4.</p> <p>7.2 TEMPERATURA DEL AIRE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-5.</p> <p>7.3 CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-4.</p> <p>7.4 CON INDICADORES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (BATERÍA, CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA). INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-3.</p> <p>7.5 CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA SEGÚN TECNOLOGÍA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-4.</p>	PIEZA	2	\$309,731.07	\$619,462.14
---	--	-------	---	--------------	--------------

Cub



8. ALARMAS: AUDIBLES Y VISIBLES. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-3.

8.1 TEMPERATURA ALTA DEL AIRE CON CORTE DE LA ENERGÍA DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA SOBREPASE LOS 39°C. FALLA EN EL FLUJO DE AIRE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-2, 2-3.

8.2 FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA. TEMPERATURA ALTA DEL AIRE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-3.

8.3 FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-3.

8.4 BATERÍA BAJA. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-3.

9. GABINETE: INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-6.

9.1 CAPACETE CON DOBLE PARED. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-4.

9.2 PUERTA FRONTAL CON AL MENOS DOS PORTILLOS Y PUERTA DE ACCESO CEFÁLICO. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-15.

9.3 CON COLCHÓN DESLIZABLE O QUE EL CAPACETE PERMITA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN E INTUBACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-15.

9.4 SEIS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DE LA CAPACETE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-4.

10. COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. COLGÓN SOFTBED DE DRÄGER, PÁG. 1.

11. CON CARRO RODABLE. CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-6.

12. SOPORTE PARA DOS TANQUES DE OXÍGENO TIPO E O D. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-6.

13. POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-6.

14. SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE: CORTINA DE AIRE O SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE QUE DISMINUYA LA PÉRDIDA DE CALOR, DEL ACCESO PRINCIPAL. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-1, 2-2.

u  
CUB

	<p>15. LÁMPARA DE LUZ DE EXPLORACIÓN O EXAMINACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 5-2.</p> <p>16. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 90 MINUTOS. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MINUTOS. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES LA BATERÍA INTERNA RECARGABLE DEBE DAR UN SOPORTE DE AL MENOS 180 MINUTOS. SE OFERTAN DOS BATERÍAS CON CAPACIDAD DE 90 MINUTOS PARA UN TOTAL DE 180 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-10.</p> <p>17. CON CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 VCD. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-1.</p> <p>18. UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 6-15.</p> <p>19. COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. FOLLETO CHOLCHÓN SOFTBED DE DRÄGER, PÁG. 1.</p> <p>20. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO GENERA UNA VELOCIDAD DEL AIRE SOBRE LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN DE 20 CM/S. INSTRUCCIONES DE USO INCUBADORA DE TRASLADO TI500, PÁG. 2-9.</p> <p>21. SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN PASIVA QUE PROPORCIONES UNA HUMEDAD RELATIVA DE AL MENOS 50-70% POR UN LAPSO DE 12 HORAS. FOLLETO TI500, PÁG. 1.</p> <p>MARCA: DRAGER MODELO: T1500 PROCEDENCIA: E.U.A.</p>					
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA					SUBTOTAL	\$5,396,276.26
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS					IVA	\$863,404.20
OCHENTA PESOS 46/100 M.N.					TOTAL	\$6,259,680.46

*Aut.*

**NOTAS GENERALES:**

1.- MEDIANTE OFICIO OF/RM/0159/02/2015, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, SOLICITA SE DECLARE DESIERTA LA PARTIDA 12 POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LA CONTRATANTE, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 16.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, POR LO QUE LA PARTIDA 12 SE DECLARA DESIERTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

2.- LAS PARTIDAS 3, 4, 10 Y 12 HAN QUEDADO DESIERTAS DEBIDO A QUE NINGÚN LICITANTE LAS COTIZÓ O HABIENDOLAS COTIZADO NO HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN BASES DE ACUERDO AL PUNTO 16.7 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

3.- LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE LA CONVOCANTE Y CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

*X*

4.- MEDIANTE OFICIO OF/RM/095/01/2015, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, SOLICITA QUE LA PARTIDA 9, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MONITORAS DE SIGNOS VITALES, QUEDE CANCELADA YA QUE DICHOS MONITORES SE ENCUENTRÁN INCLUIDOS EN LA PARTIDA 5 (CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS), POR LO QUE LA PARTIDA 9 QUEDA CANCELADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

5.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR E INSTALAR LOS BIENES OFERTADOS EN TIEMPO Y FORMA A MÁS TARDAR 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, DE ACUERDO A LA NOTA GENERAL UNO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.--

6.- LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL: **ALMACÉN DE BIENES INVENTARIABLES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA**, UBICADO EN CALLE EMILIO CARRANZA N°1306, COL. SAN MARTIN DE PORRES, APIZACO, TLAX. PREVIA CITA A LOS TELÉFONOS 01 241 41 7 94 20 O 41 7 94 33. TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS ENUNCIANDO: PROGRAMA, NÚMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y NÚMERO DE FACTURA. DE ACUERDO AL PUNTO 22.1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.-----

7.- ASIMISMO, LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES A PARTIR DE RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. -----

8.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERÁN COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 246 46 5 09 00 EXT. 3706. ASÍ MISMO, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATANTE PARA LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE, PUDIENDOSE COMUNICAR AL TELEFONO 246 46 2 10 60 EXT. 8029.-----

9.- LOS LICITANTES ACEPTAN QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORGADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

10.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. -----

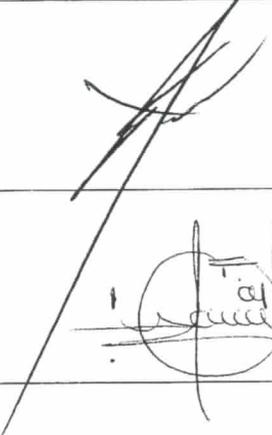

11.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.-----

12.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE. -----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES. -----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ	

C. Gut

-----FIN DE TEXTO-----